
Новый поликортикальный имплантат

Radix-iCort



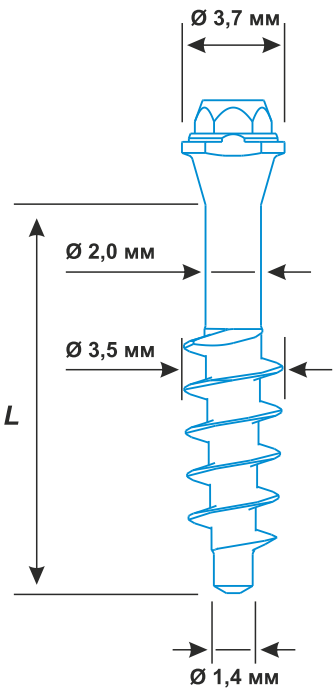


Абатмент диаметром 3,7 мм предназначен для винтовой фиксации

Коническое тело имплантата, диаметром от 2,0 мм до 1,4 мм

Коническая резьба, диаметром 3,5 мм, уменьшается к верхушке имплантата. Это упрощает его введение под большим углом к кортикальной пластинке

L, мм	код
10	CORT2010
12	CORT2012
14	CORT2014
16	CORT2016
18	CORT2018
20	CORT2020
22	CORT2022

Сверло D180




Сверло D200



Отвертка прямая S635 (для ключа N370)




Ключ



N370

Динамометрический ключ-трещотка N200



+375 17 369 86 57

www.radix.ru
www.implant.by

RADIX
Dental Implants System

Новый поликортикальный имплантат


Radix-iCort



Снятие оттиска

Открытая ложка

Трансфер
XPIC37



Имплантат

Закрытая ложка

Трансфер
XPOP37



Имплантат

Колпачок выжигаемый



XCP3720

Аналог абатмента



A3720

Винт фиксирующий



X160

Титановая манжета (колпачок)



Используется для временных конструкций

XCT3720L


Колпачок титановый



Используется как защитный колпачок

XCT3720

Отвертки

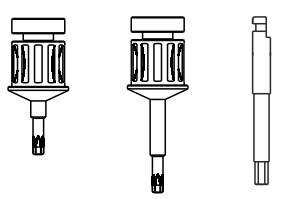

XN125-1 **N125-2** **X125**


+375 17 369 86 57

www.radix.ru
www.implant.by

RADIX
Dental Implants System

Одноэтапный имплантат с винтовой фиксацией протеза

Radix-DM

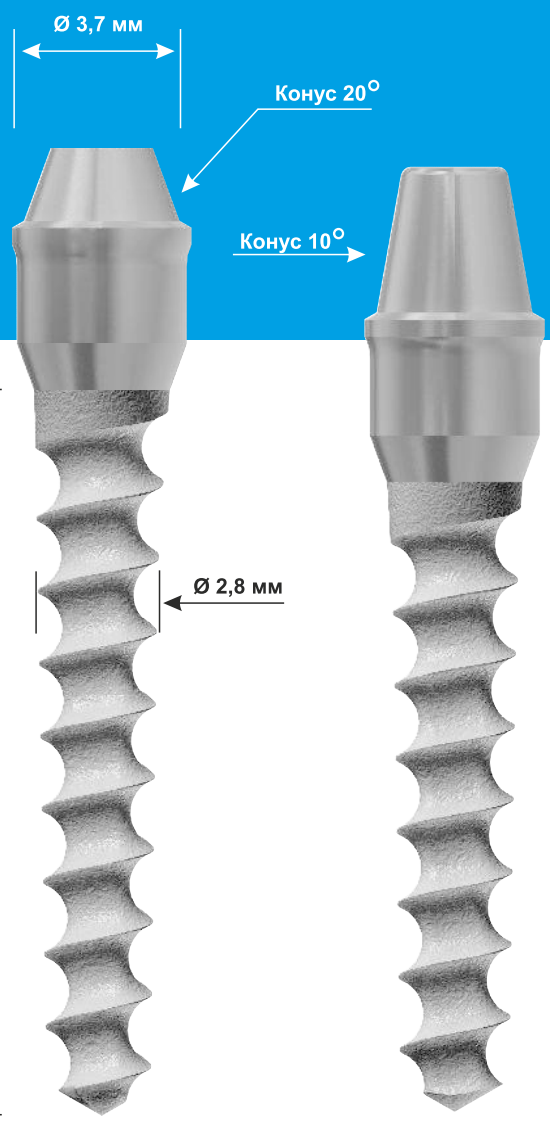


Абатмент диаметром 3,7 мм предназначен для винтовой фиксации

Коническая резьба, диаметром 2,8 мм, уменьшается к верхушке имплантата


Чистый титан Grade 4 специально обработанный давлением для повышения механической прочности

L, мм	Конус 20 градусов	Конус 10 градусов
10	52010	51010
13	52013	51013
15	52015	51015
18	52018	51018

Сверло D180



Сверло D230



Ключ




N37


Отвертка прямая S635 (для ключа N37)



Динамометрический ключ-трещотка N200



Отвертки



XN125-1 **N125-2** **X125**

+375 17 369 86 57


www.radix.ru
www.implant.by

RADIX
Dental Implants System

Одноэтапный имплантат с винтовой фиксацией протеза

Radix-DM

Снятие оттиска

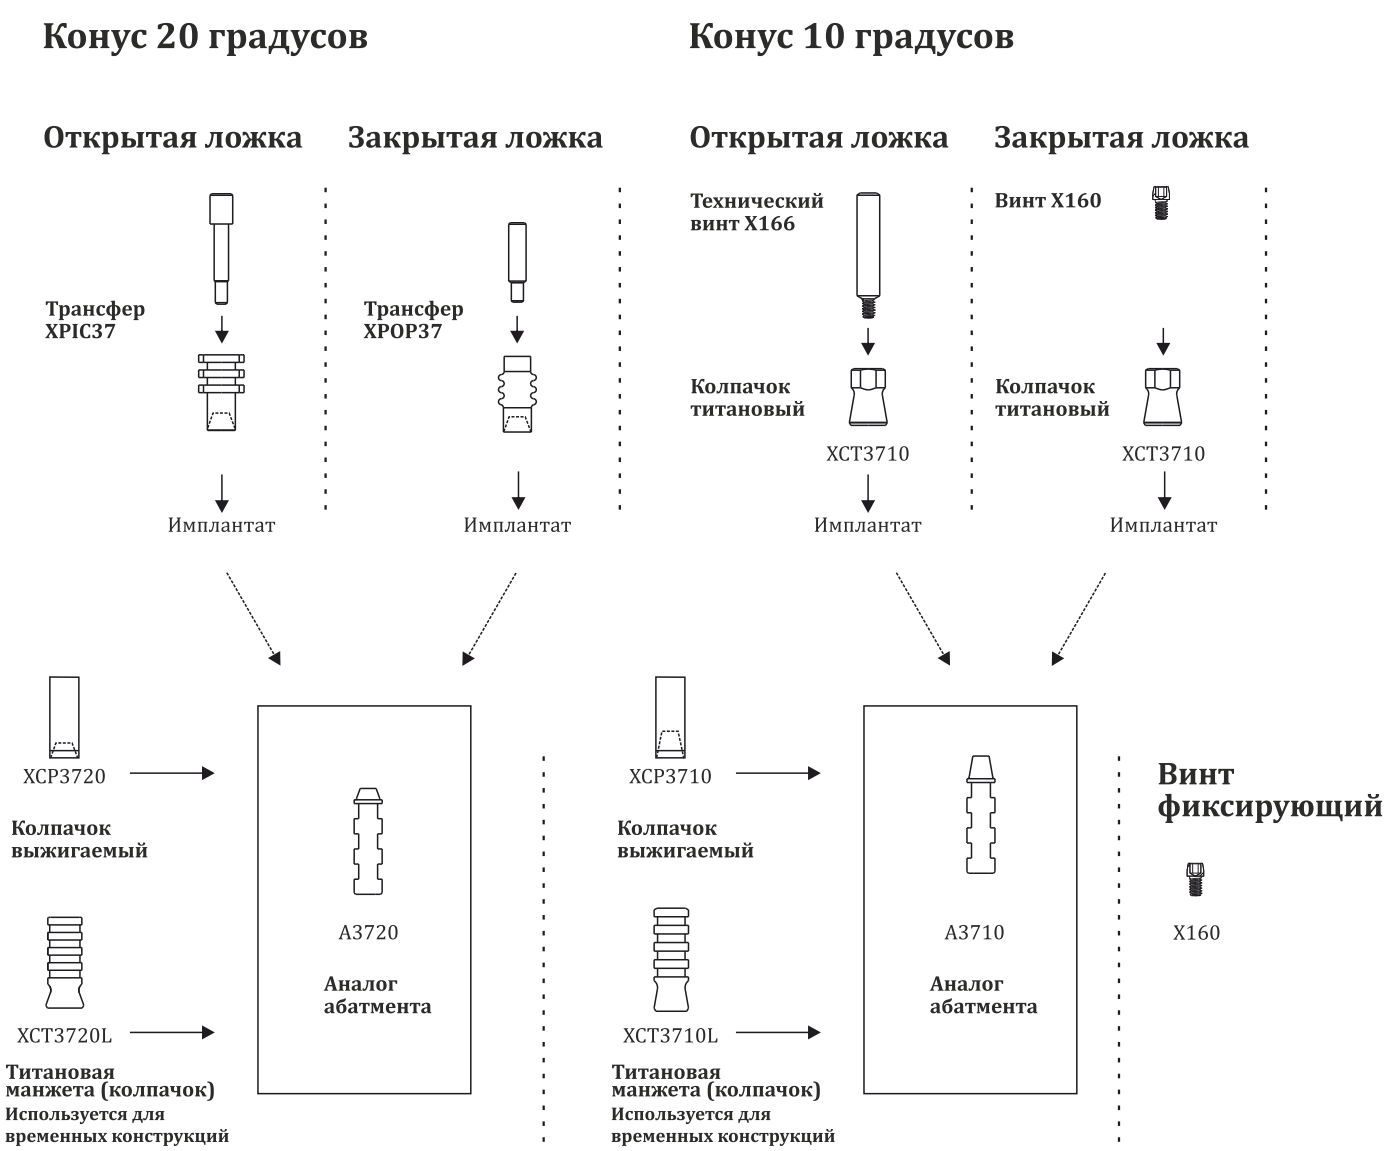


+375 17 369 86 57
www.radix.ru
www.implant.by

RADIX
Dental Implants System

Одноэтапный имплантат

Radix-I

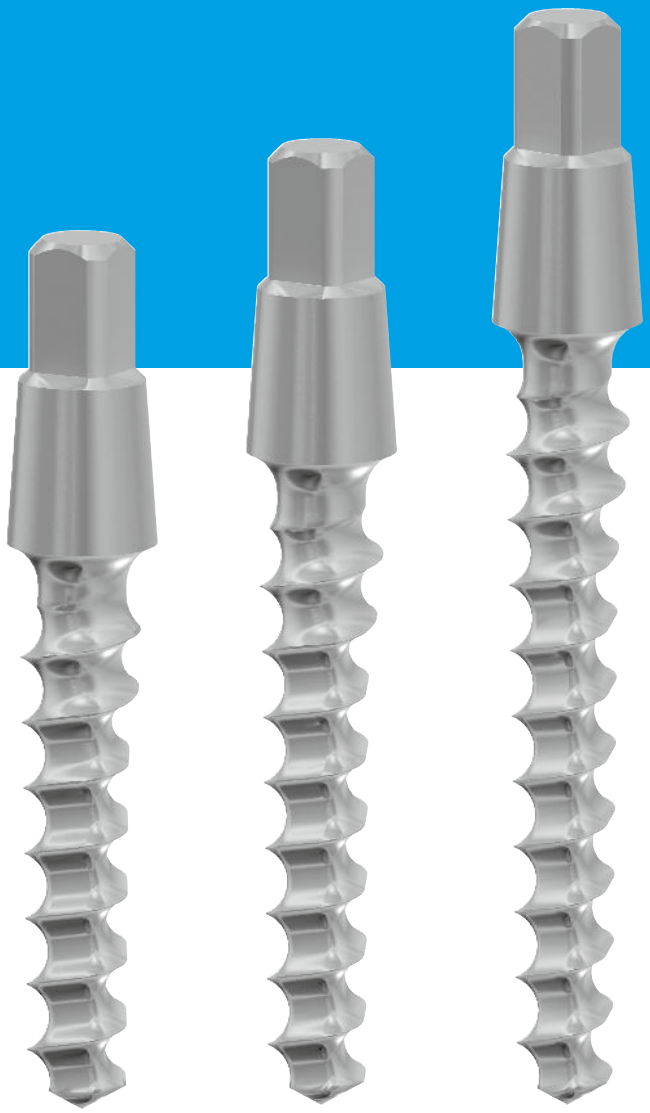

Применяется для постоянного и для временного протезирования

Выпускается в варианте с текстурированной или нетекстурированной поверхностью

Коническая резьба, диаметром 2,8 мм, уменьшается к верхушке имплантата

Чистый титан Grade 4 специально обработанный давлением для повышения механической прочности

Высота, мм	Маркировка
10	310
13	313
15	315
18	318


Сверло D180



Сверло D230



Ключ



K31

Аналог имплантата A130



+375 17 369 86 57

www.radix.ru
www.implant.by

RADIX
Dental Implants System